



CEAG004


OPERADOR DEL CROMATOGRFO DE GASES HP 5890

Descripción:

Este curso provee al analista la información necesaria para el manejo óptimo del cromatógrafo de gases HP 5890, así como de la operación automatizada a través del inyector automático HP 7673. Se efectúan prácticas de laboratorio.

Temario:

- Descripción del instrumento
- Implementación de un método
 - Control de temperaturas
 - Sistema de inyección
 - Medición correcta de flujos
 - Detectores
- Sistema de salida de señal
- Operación del Inyector Automático
- Métodos
- Secuencias

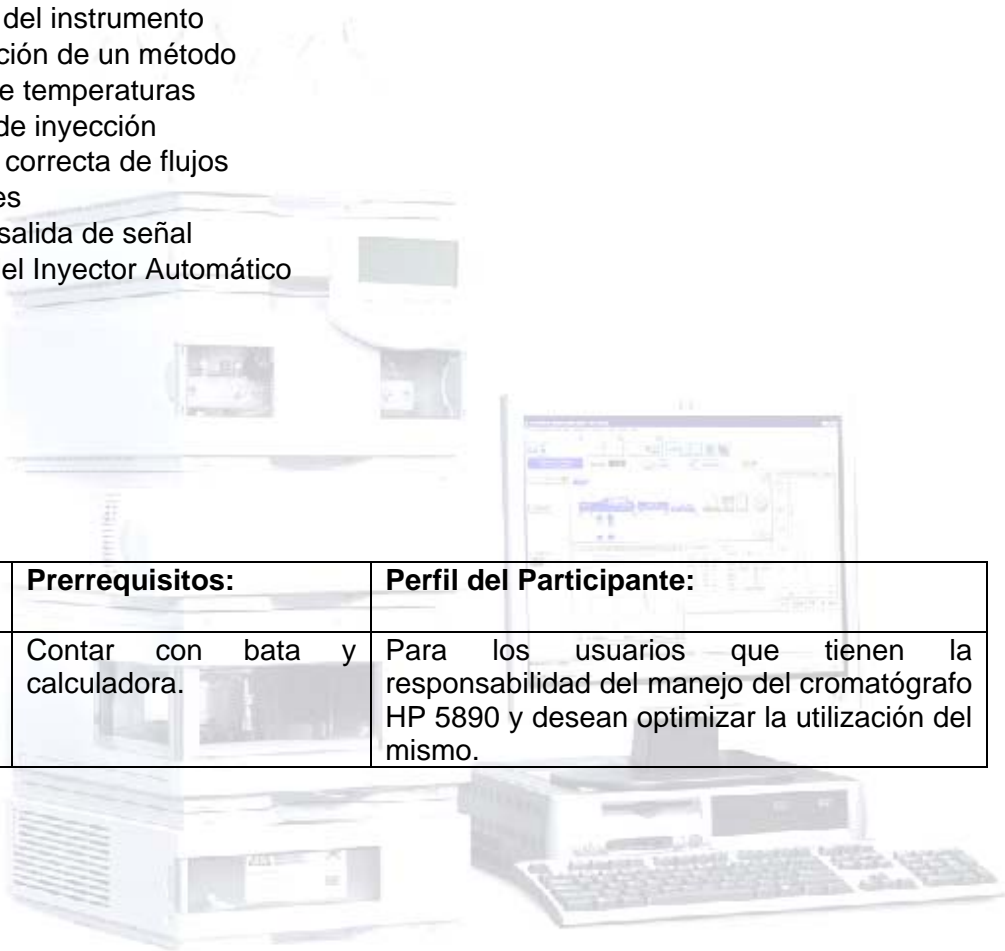

Duración del curso:	Prerrequisitos:	Perfil del Participante:
5 días. Horario: 8:00 a 17:00 h	Contar con bata y calculadora.	Para los usuarios que tienen la responsabilidad del manejo del cromatógrafo HP 5890 y desean optimizar la utilización del mismo.