


H5926A
OPERADOR DEL CROMATOGRAFO DE GASES AT 6890

Descripción:

Este curso provee la información necesaria para el manejo del cromatógrafo de gases AT 6890, así como la de la operación automatizada a través del inyector automático AT 7673. Se efectúan prácticas de laboratorio. Especialmente complementado con fundamentos que permitan entender el funcionamiento del instrumento y sus partes.

Temario:

- Descripción del instrumento
- Control de temperaturas
- Sistemas de inyección
- Control electrónico de flujos
- Detectores
- Sistema de salida de señal
- Operación del Inyector Automático
- Ejecución de un método
- Ejecución de una secuencia
- Integración automática
- Calibración básica
- Generación de reporte corto
 - % Área
 - Estándar externo con un nivel

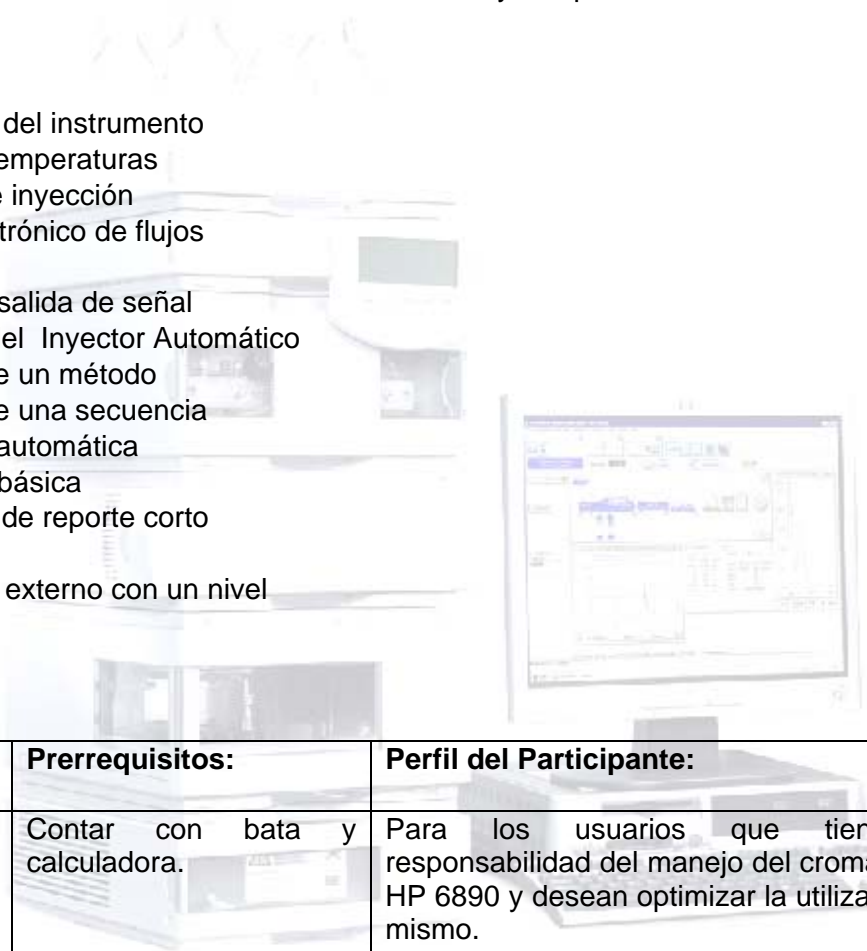

Duración del curso:	Prerrequisitos:	Perfil del Participante:
5 días. Horario 8:00 a 17:00 hrs	Contar con bata y calculadora.	Para los usuarios que tienen la responsabilidad del manejo del cromatógrafo HP 6890 y desean optimizar la utilización del mismo.